

令和 2 年 10 月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定機器および測定試薬の変更に伴い内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*


### ■内容変更項目

項目No.	検査項目名	変更箇所	新	旧
3531	プロカルシトニン (PCT)	検査方法	CLIA 法	ECLIA 法

※基準範囲等に変更はございません。


### ■新旧の相関

[全体]

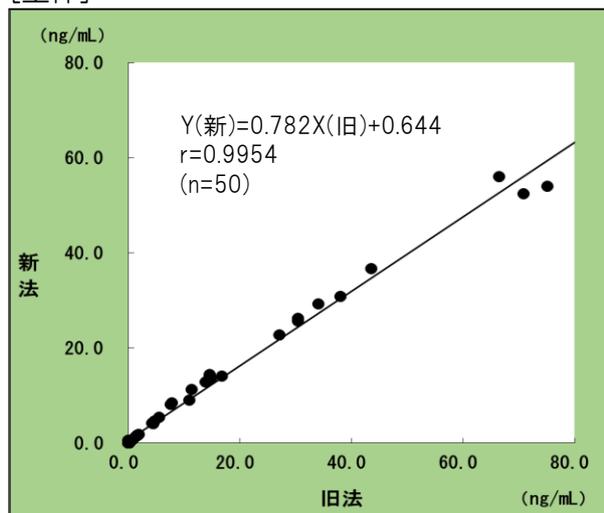

(社内検討データ)

[低値域]

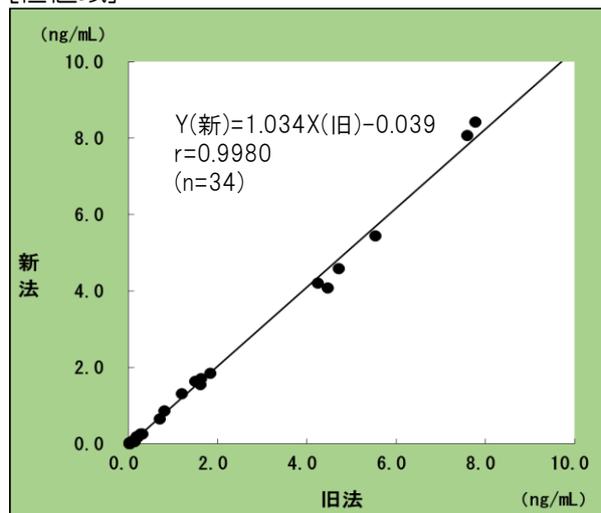

(社内検討データ)

### ■判定一致率

		旧法(ECLIA) ng/mL		
		<0.50	0.50~<2.00	2.00≦
新法 (CLIA) ng/mL	<0.50	21		
	0.50~<2.00		7	
	2.00≦			22

基準範囲：0.05 ng/mL 以下

敗血症鑑別診断のカットオフ値：0.50 ng/mL 未満

敗血症重症度判定のカットオフ値：2.00 ng/mL 以上

一致率：100.0%(n=50) (社内検討データ)

### ■変更期日

令和 2 年 10 月 31 日 (土) 受付分より

以上

20-1035