

令和4年9月

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、別表に掲げる項目につきまして検査内容の変更を
させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。
誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い
申し上げます。

敬具

***** 記 *****

■検査内容変更項目

実施期日 令和 4年10月 1日（土）受付分より

検査内容変更一覧

コード (統一コード)	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
32567 (4Z271)	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP)	検査方法 検体量	CLIA 0.5 mL	CLEIA 0.4 mL	測定機器及び 測定試薬の変更
32568 (4Z272)	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド 前駆体N端フラグメント (NT-proBNP)	検査方法 報告上限 報告下限 溶血の影響	CLIA 上限なし pg/mL 35未満 pg/mL コメントなし	ECLIA 70000以上 pg/mL 5未満 pg/mL コメントあり	測定機器及び 測定試薬の変更
22090 (5F018)	HBc抗体-IgM	検体量	0.3 mL	0.5 mL	検体量の見直し
08045 (5G520)	抗血小板抗体	保存	冷蔵	凍結	保存条件の見直し
34325 (3L135)	エトスクシミド	保存	冷蔵	凍結	保存条件の見直し
04007 (3G065)	25-OHビタミンD(ECLIA)	報告上限	240.0以上 ng/mL	200.0以上 ng/mL	測定試薬の変更


22-0922

○ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)の測定機器および測定試薬を変更致します。
基準範囲の変更はありません。


◆新旧二法の相関図

【全体】

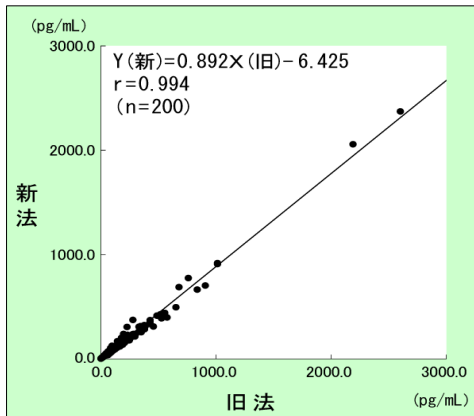

(社内検討データ)

【正常・要経過観察域】

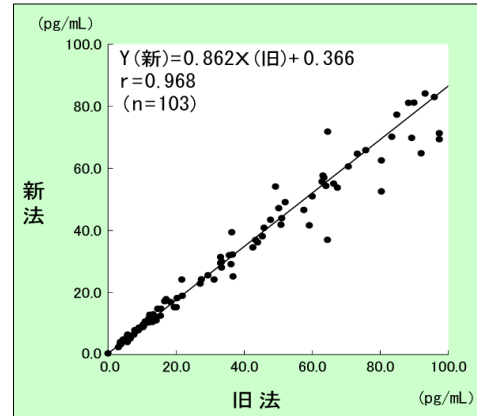


(社内検討データ)

○ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)の測定機器および測定試薬を変更致します。基準範囲の変更はありません。


◆新旧二法の相関図

【全体】

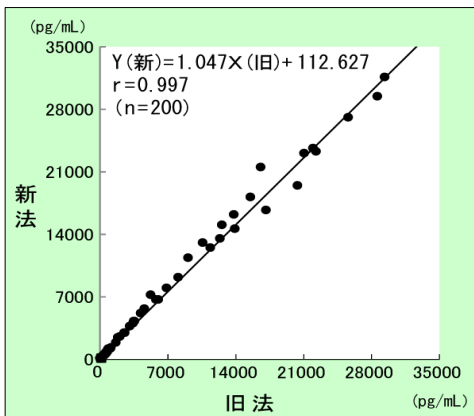

(社内検討データ)

【正常・要経過観察域】

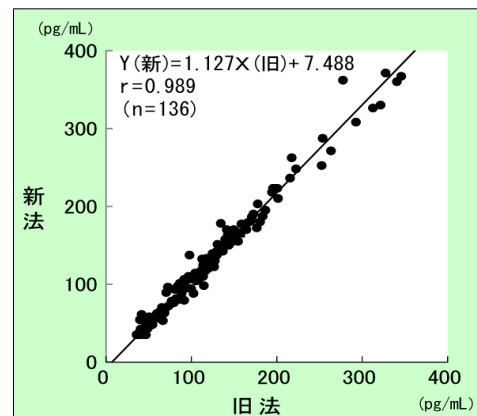


(社内検討データ)

○25-OHビタミンD(ECLIA)

25-OHビタミンD(ECLIA)の改良試薬への変更に伴い、測定範囲を変更致します。
基準範囲の変更はありません。

◆新旧二法の相関図

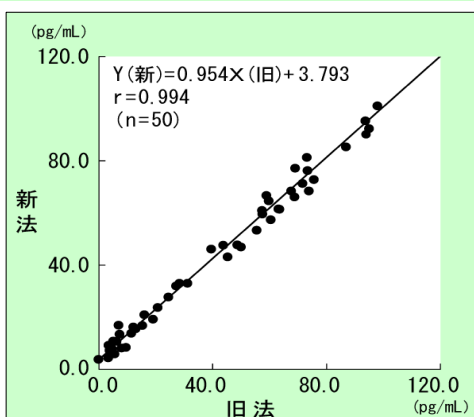

(社内検討データ)