

令和5年1月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定試薬の販売終了に伴い、同一メーカーの新試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。新試薬は現行試薬と比較して中和抗体価と良好な相関があり、判定保留が減少します。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

***** 記 *****


■内容変更項目

項目コード No.11415 ムンプス IgG

	新	旧
測定試薬	ムンプスIgG「生研」 [デンカ株式会社]	ウイルス抗体EIA「生研」 ムンプスIgG [デンカ株式会社]

※基準範囲、検査方法等に変更はありません。

■新旧の比較

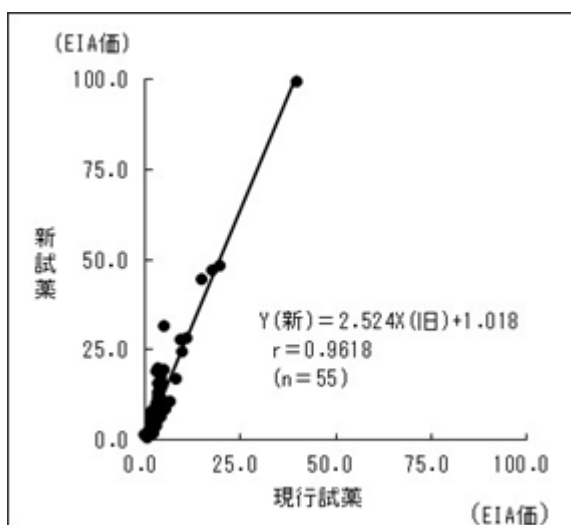

		現行試薬		
		(-) 2未満	(±) 2.0~3.9	(+) 4.0以上
新試薬	(-) 2未満	5	1	0
	(±) 2.0~3.9	2	6	0
	(+) 4.0以上	1	24	16

陽性一致率：100% (16/16)
陰性一致率：62.5% (5/8)
判定一致率：49.1% (27/55)

(社内検討データ)

■変更期日

令和5年2月28日(火) 受付分より

以上

23-0150